


Introduction : Les poignées de scialytique stériles permettent la manipulation de l'éclairage du champ opératoire. Elles sont indispensables et systématiquement utilisées dans les salles de blocs opératoires. Jusqu'à présent, des poignées restérilisables étaient utilisées au CHU de Caen. Cependant, le contexte de sous-traitance de la stérilisation a révélé un coût important pour ces dispositifs, et l'utilisation de housses stériles à usage unique (UU) est apparue comme une alternative intéressante.

Démarche de passage à l'usage unique :

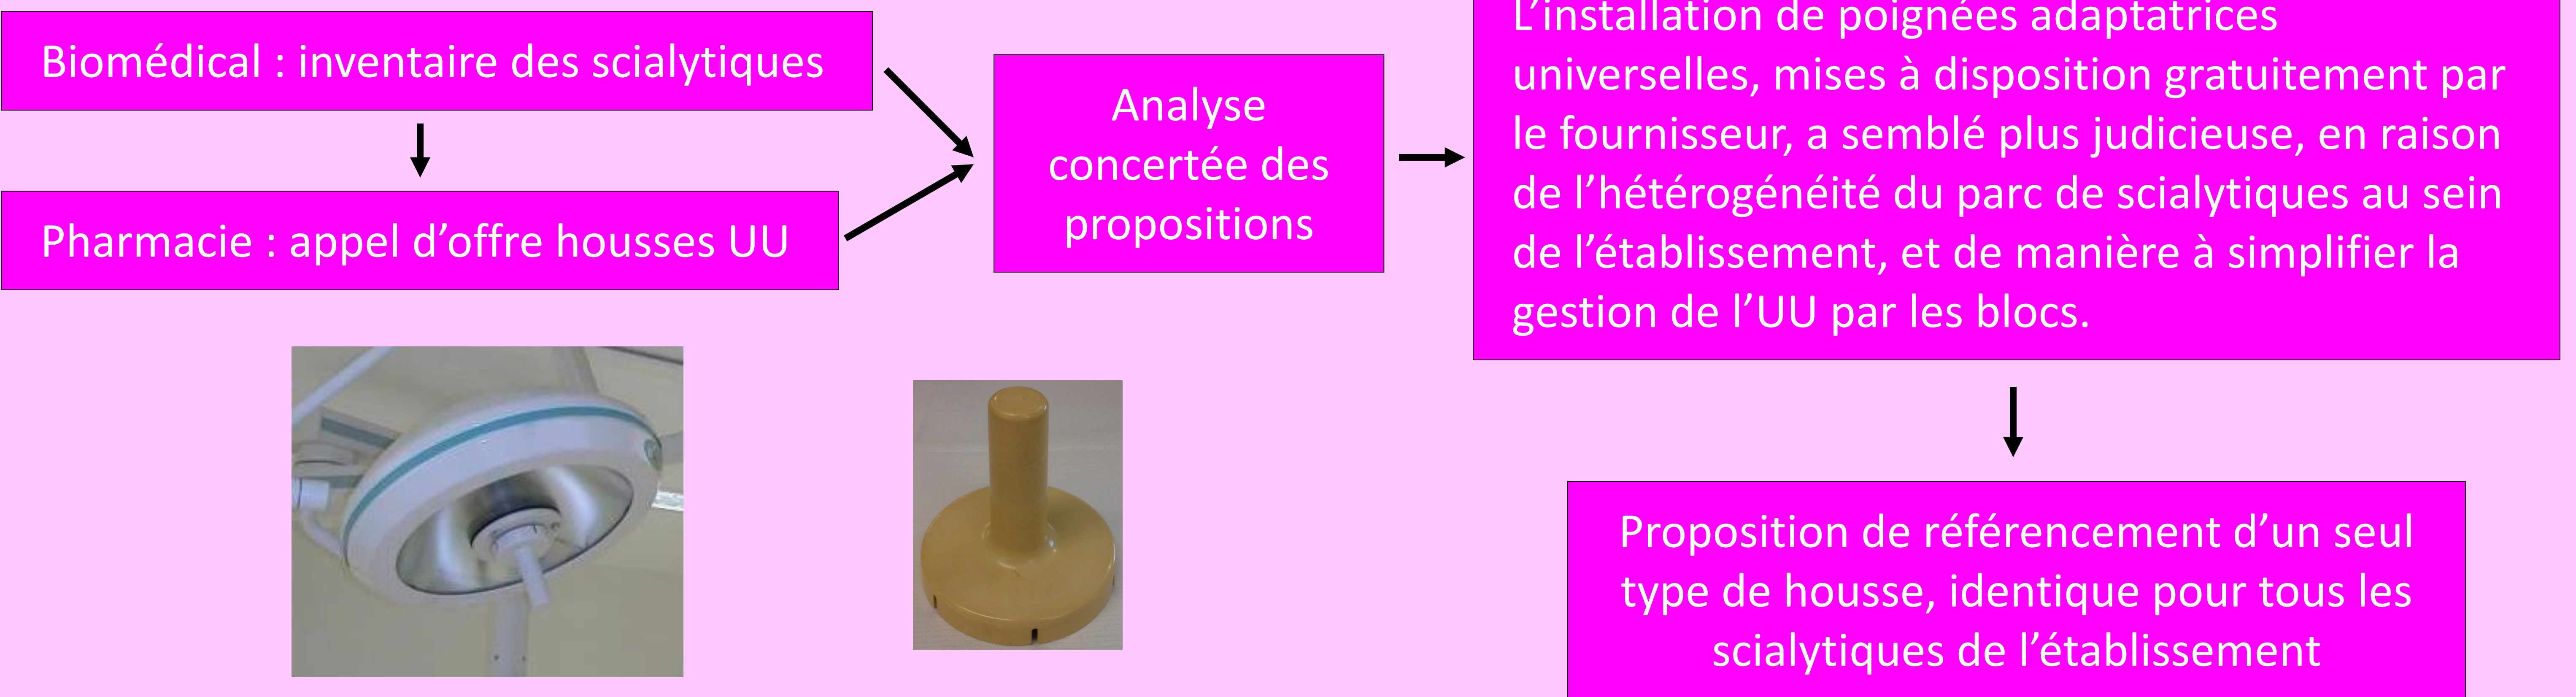

Résultats :

Evaluation économique

Analyse statistique des factures sur 4 mois

545 poignées stérilisées/mois

6540 poignées stérilisées/an

Poignées restérilisables

Housses UU

Stérilisation ⇔ 17 200€/an

Achat ⇔ 2 877€/an

Achat : 30 poignées/an
⇔ 4 900€/an

21 100€/an

2 877€/an

Evaluation des usagers

Essai des housses dans 2 blocs (orthopédique et digestif)

Critère évalué	Nombre de répondants	Fonction	Excellent ou bon
Ouverture du sachet	9	IBODE	89 %
Présentation du sachet	9		100 %
Souplesse du couvre-poignée	6		67 %
Facilité de mise en place	7		71 %
Tenue du couvre-poignée	8		100 %
Extraction	8		88 %
Confort	6	Chirurgien	100 %
Préhension	6		100 %

Satisfaction globale des usagers

Economie annuelle du point de vue de l'établissement évaluée à 18 222€

Conclusion : La sous-traitance de la stérilisation a été l'occasion de développer une réflexion commune entre le service biomédical et la pharmacie autour des dispositifs médicaux. Les actions menées spécifiquement sur les housses de poignées de scialytique à usage unique ont pu générer une économie substantielle du point de vue de l'établissement tout en maintenant une qualité de soins satisfaisante.